


Kiírási szöveg:

Oventrop „Aquaström P“ mintavevő szelep mikrobiológiai-kémiai vizsgálatához a DIN EN ISO 19458 szerint ivóvíz-rendszerekhez az ivóvízrendeletnek megfelelően. DVGW W 579 szerint tanúsítva.

Szeleptest DIN EN 1982 és DIN 50930-6 szerint vörösöntvényből, orsó és kilépő ív rozsdamentes acélból, fém-fém tömítés, hőálló PTFE kiegészítő tömítéssel, kilépő ív fertőtlenítéshez lángálló és 360°-ban elforgatható, így tetszőleges pozícióban forgatható, könnyen felszerelhető mellékelt imbuszkulcs SW5, fémlappal a mintavételi hely jelölésére a DIN EN ISO 19458 szerint.

Műszaki adatok: Ivóvíz szerelési rendszerek a TrinkwV szerint
Alkalmazási terület:

Üzemi hőmérséklet: max. 90°C

Üzemi nyomás: max. 10 bar (PN10)

Telepítés: tetszőleges, könnyen hozzáférhető, ház és kimeneti ív 360°-ban elforgatható


Anyagok: Szeleptest DIN EN 1982 és DIN 50930-6 szerinti vörösöntvény. Orsó és kimeneti ív rozsdamentes acélból
Tömszelence tömítés PTFE-ből
fém/PTFE

Verziók:

DN 8	G ¼	Cikkszám:
DN 10	G ¾	4209102
		4209103



„Aquaström P“

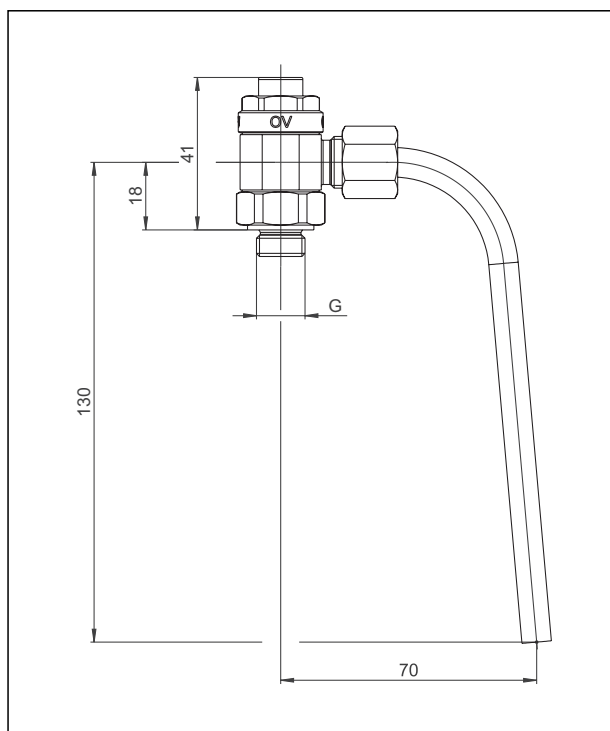

Méretetek